Absorgyn Podkłady ginekologiczne i prostokątny wkład chłonny

Wykonane z delikatnej włókninowej warstwy zewnętrznej.
Wewnętrzna warstwa to włóknina oraz celulozowy wkład chłonny, który zapewnia wysokie właściwości absorpcyjne.
Folia umieszczona pomiędzy włókniną a wkładem chłonnym stanowi część izolacyjną – skutecznie chroni przed przemakaniem (w wersji z folią).

Zastosowanie:

- Wyroby są używane do pochłaniania wydzielin oraz zwiększenia higieny i komfortu u kobiet w okresie połogu lub po przebytych zabiegach i operacjach ginekologicznych.
- Rozmiar 35 cm x 11 cm to prostokątny wkład chłonny dla kobiet po porodzie oraz osób z lekkim nietrzymaniem moczu.
- W wersji jałowej podkłady służą do pochłaniania płynów i wydzielin po porodzie lub zabiegach urologiczno-ginekologicznych

Rodzaje:

- jałowe i niejałowe
- z folią i bez folii
- prostokątne i anatomiczne


Rozmiary i pakowanie:

- dostępne w rozmiarach: 22 cm x 9 cm, 27 cm x 7,5 cm, 28 cm x 9 cm, 34 cm x 9 cm, 35 cm x 11 cm,
- jałowe, pakowane po 10 szt. lub po 5 szt. (indywidualnie)
- niejałowe, pakowane po 10 szt., 15 szt. (rozmiar 35 cm x 11 cm) i 20 szt. (rozmiar 22 cm x 9 cm)



Rectangular version / Rechteckige Version / Прямоугольная версия / Prostokątna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:

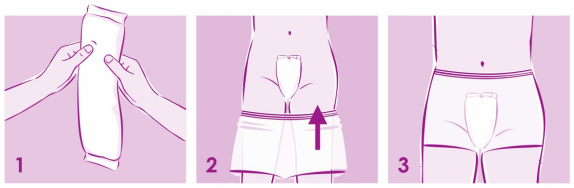


Towels should be changed regularly. / Die Vorlagen sollten regelmäßig gewechselt werden. / Прокладки следует регулярно менять. / Podkłady należy zmieniać regularnie.

The manufacturer recommends stabilisation with Seni Fix elastic supporting briefs. / Der Hersteller empfiehlt die Fixierung mit den elastischen Höschen von Seni Fix./ Производитель рекомендует использовать сетчатые трусики-фиксаторы Seni Fix для закрепления изделия. / Producent zaleca stabilizację za pomocą majtek siatkowych Seni Fix.

Anatomical version / Anatomische Version / Анатомическая версия / Anatomiczna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:

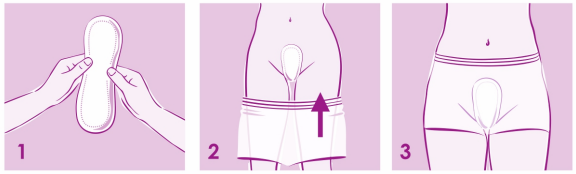

Towels should be changed regularly. / Die Vorlagen sollten regelmäßig gewechselt werden. / Прокладки следует регулярно менять. / Podkłady należy zmieniać regularnie.

The manufacturer recommends stabilisation with Seni Fix elastic supporting briefs. / Der Hersteller empfiehlt die Fixierung mit den elastischen Höschen von Seni Fix./ Производитель рекомендует использовать сетчатые трусики-фиксаторы Seni Fix для закрепления изделия. / Producent zaleca stabilizację za pomocą majtek siatkowych Seni Fix.






MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026

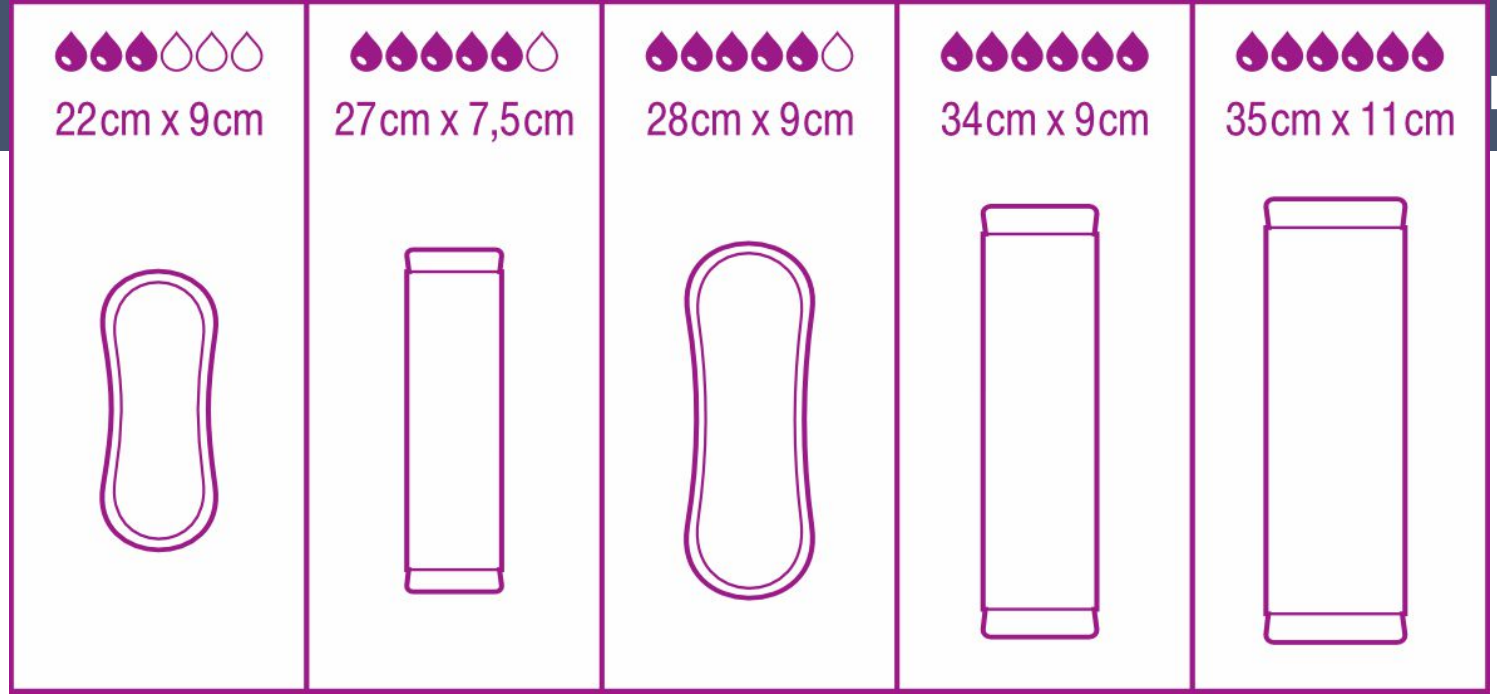

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026